Guía rápida de inicio

Lector de Pruebas Rápidas (RTR-1)

Instrumentos y Accesorios

1 x Adaptador de Corriente 12V/2A

1 x Adaptador de Casetes

1 x Puntero y receptáculo

1 x Manual de Operaciones

1 x Tabla de pruebas disponible



1 x Lector de Pruebas Rápidas ALTA

Desempaque e Instalación

1. Retire con cuidado el instrumento de la caja y guarde todo el contenido que vino con el instrumento dentro de la caja para futura referencia.
2. Coloque el instrumento en una superficie limpia y nivelada, donde la temperatura ambiental sea entre 10-40°C y la humedad relativa sea de < 85%.

Configuración de la Impresora

Tire de la palanca hacia arriba para abrir la tapa de papel

Coloque el papel termal en la ranura superior y cierre la tapa con la longitud corta del papel que sobresale

Presione el interruptor de alimentación de papel hasta que el papel se deslice

Configuración del Instrumento

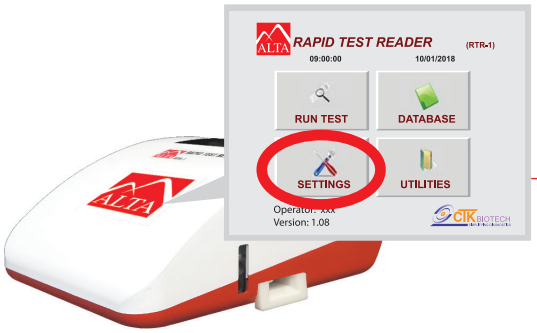

Asegúrese que el adaptador de casete este instalado
Encienda el instrumento y espere a que el menú principal inicie

Para establecer la configuración de la información del laboratorio: Settings -> Laboratory Setup

Para establecer la hora :
Settings -> Date and Time

Para añadir una prueba:
Escanear el código de barras deseado de la tabla de pruebas disponibles o introducirlo manualmente y presione Add (añadir)

Para eliminar una prueba:
Seleccione la prueba que desea eliminar y presione Delete test (eliminar la prueba).

Para instrucciones detalladas, por favor consulte el Manual de Instrucciones del Lector de Pruebas Rapidas

Ejecutando la Prueba Rápida

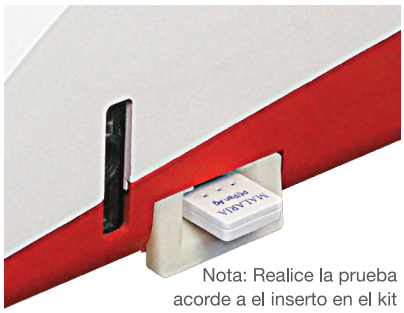

Nota: Realice la prueba acorde a el inserto en el kit

1 Inserte la prueba rápida en el espacio del adaptador del casete

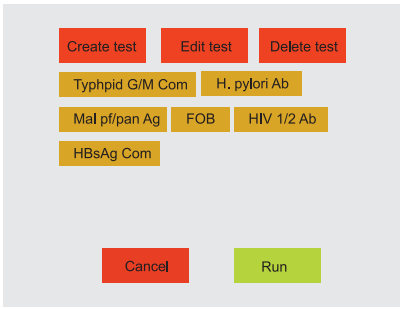

2 Seleccione en el menú de pruebas del lector RTR, asegurándose de elegir la prueba correcta

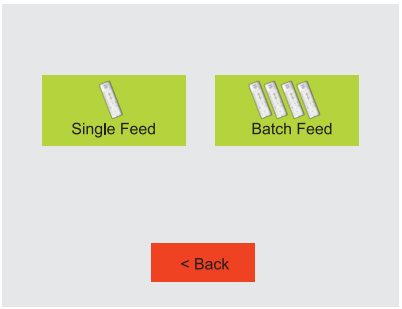

3 Seleccione una prueba individual o varias pruebas según corresponda

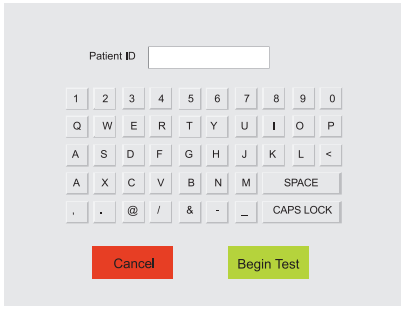

4 Ingrese el número del paciente escaneando un código de barras o introduciéndolo manualmente. Presione Begin test (inicie la lectura).

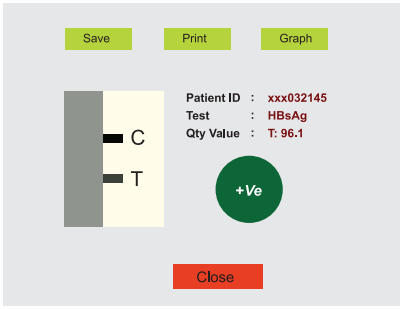

5 Después de varios segundos, los resultados aparecerán en la pantalla



6 Guarde los resultados, a continuación, seleccione Print (imprimir) para imprimir una copia de la lectura

* Por favor, no lea el casete que haya excedido el tiempo de lectura del resultado especificado en el inserto del kit de prueba
* Los resultados de la prueba no se guardan automáticamente al lector; se deben guardar presionando el botón Save (guardar) en la pantalla de resultados.

Base de Datos

EXPORTACIÓN	Inserte una unidad de USB en cualquiera de los dos puertos USB, presione Export (exportar).
IMPRIMIR	Para imprimir resultado, seleccione el resultado deseado, presione Print (imprimir)
VISTA	Para ver la imagen, seleccione el resultado deseado, presione Image (imagen)
ELIMINAR	Para eliminar un resultado, seleccione el resultado deseado, presione Delete (eliminar)
ELIMINAR TODO	Para eliminar todos los resultados, presione Delete all (eliminar todo)

Limpieza

- Descontamine las superficies usando etanol u otro surfactante adecuado
  - No utilice acetona u otros solventes fuertes
- No rocíe el instrumento o sumérjalo en ningún líquido.
- Preste atención especial al adaptador del casete, a la pantalla táctil y al puntero